solventum
Tegaderm™
I.V. Management


Produkthinweise
3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced Fixierverband 1685 für großlumige Katheter

3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced Fixierverband 1685

Bei der Entwicklung von 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced Fixierverband 1685 wurde auf eine moderne Katheterfixierung und ein sanftes Entfernen Wert gelegt, um höchsten Patientenkomfort zu gewährleisten.

Modellierbare Ränder
Spezielle Technologie, um ein Aufrollen der Ränder zu reduzieren.


Breiter Fixierstreifen mit Kerbe
Unterstützt die gleichmäßige Applikation und sorgt für mehr Stabilität. Dank der Perforation lässt sich der Verband leicht entfernen.

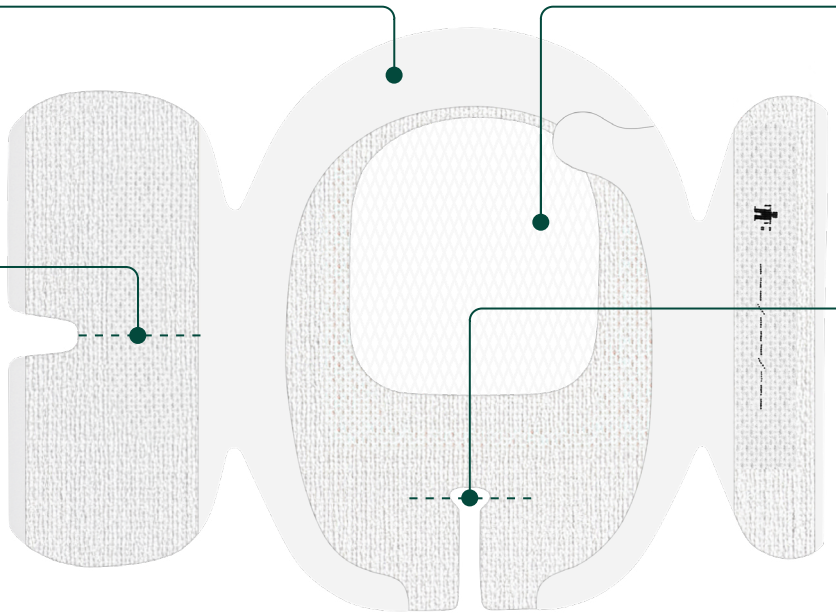


Die wasserdichte, sterile Barriere schützt vor Kontamination von außen*
Hochgradig atmungsaktive, transparente Folie.

Schlüssellochkerbe mit Perforation
Dank der Schlüssellochkerbe kann der Verband gut um Katheterlumen anmodelliert werden. Die Perforation erleichtert das Anmodellieren um große Katheter.

Großlumige Katheter









Sichtbarkeit der Einstichstelle
Der transparente Verband ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Komplikationen an der Einstichstelle.


Katheterfixierung
Entwickelt, um Bewegung und Dislokation von Kathetern zu minimieren.

Gleichmäßige Applikation
Sichere und einfache Platzierung dank Applikationsrahmen für gleichmäßige Applikation.

Patientenkomfort
Der Verband kann bis zu 7 Tage getragen werden, die Häufigkeit von Verbandswechseln und des Legens neuer Katheter wird so potenziell reduziert.

*_In-vitro_-Versuche belegen, dass die Folie eine Barriere gegen Viren mit einem Durchmesser von 27 nm und größer bildet, solange der Verband intakt und nicht durchlässig ist.

1685

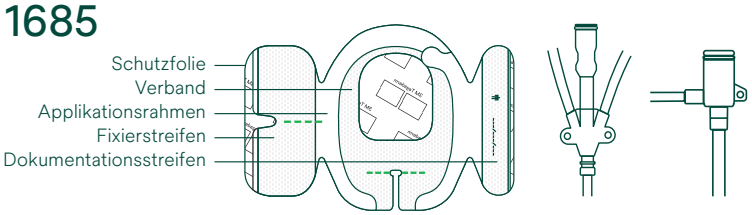


Vorbereiten




Bereiten Sie die Einstichstelle gemäß Ihrem Pflegestandard vor. Der Bereich muss vollständig trocken und fettfrei sein. Vor dem Abziehen der Schutzfolie muss die Schlüssellochkerbe an der Perforation geöffnet werden. Ziehen Sie erst danach die Schutzfolie vom Verband ab.

Anmodellieren

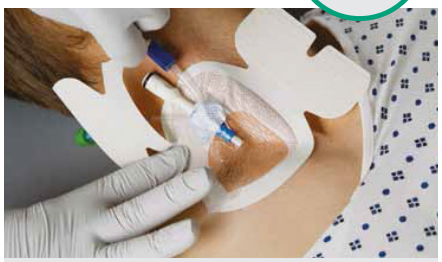

Platzieren Sie das Sichtfenster über der Einstichstelle. Achten Sie darauf, den Verband beim Applizieren nicht zu dehnen. Modellieren Sie den gesamten Verband gut an, damit er nach dem Entfernen des Applikationsrahmens sicher haftet.

Fixieren

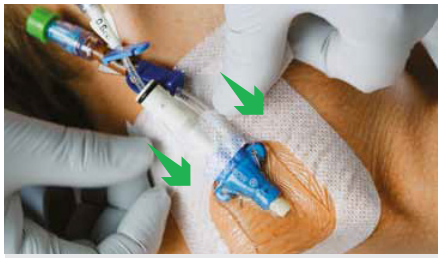

Bringen Sie den Fixierstreifen unter dem Schlauch und überlappend mit dem Verband an. Entfernen Sie die klebstofffreien Laschen.

Fixieren



Bringen Sie den Dokumentationsstreifen wie im Bild gezeigt an. Entfernen Sie die klebstofffreien Laschen.

Kontrollieren



Wechseln Sie den 3M™ Tegaderm™ Advanced Fixierverband alle sieben (7) Tage, wenn sich der Verband lockert oder er verschmutzt ist oder im Fall einer Schwellung, einer sichtbaren Drainage oder bei Verlust der Sichtbarkeit der Einstichstelle.

Entfernen



Öffnen Sie den Fixierstreifen an der Perforation. Nach dem Öffnen an der Perforation halten Sie den Fixierstreifen und lösen den Verband bis zur Kathetereinstichstelle langsam und in einem flachen Winkel ab. Vermeiden Sie eine Verletzung der Haut, indem Sie den Verband zurückziehen, anstatt ihn von der Haut nach oben abzureißen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Produkts.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Gesamtgröße Verband	Stk./Pkg.	PZN	PZN	Pharmacode	MiGeL
1685	8,5 cm x 11,5 cm	50	07644752	5021923	7079140	35.05.10.03.1

Solventum Medical Surgical

Solventum Germany GmbH
Edisonstrasse 6, 59174 Kamen, Germany
solventum.com/de-de

KCI Austria GmbH
Am Europlatz 2, Euro Plaza 4, 1120 Wien, Austria
solventum.com/de-at

KCI Medical GmbH
Eggstrasse 91, Rüschlikon, CH 8803, Switzerland
solventum.com/de-ch

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Solventum-Ansprechpartner.

© Solventum 2026. Solventum und das S-Logo sind Marken von Solventum oder dessen verbundenen Unternehmen. 3M und das 3M-Logo sind Marken von 3M. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. #2019-0050